

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อ ตู้อบเด็กแบบลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้

1. ความเป็นมา

ด้วยแผนกห้องคลอด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ให้ความอบอุ่นและเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ในวงเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความอบอุ่น ควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายทารกระหว่างห้องคลอดและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงการเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล ป้องกันทารกเกิดอันตรายจากสภาพแวดล้อมภายนอก ป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำระหว่างทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เคลื่อนที่ได้สะดวกและปลอดภัย

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีใ้งานก่อสร้าง)

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี เงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561


4. คุณสมบัติและรายละเอียด

4.1 ตู้เด็กมีกระโถมเป็นฝาครอบ 2 ชั้นทุกด้าน ตัวตู้เด็กวางอยู่บนรถเข็นและมีที่จับสามารถ เคลื่อนย้ายไปมาได้

4.2 ตู้เด็กมีประตูปิด-เปิด สามารถเลื่อนเบาะที่นั่งนอนเด็กออกมาได้ มีช่องหน้าต่างปิด-เปิด 3 ช่อง ทั้ง ด้านหน้าและด้านศีรษะเด็ก โดยด้านหน้าจะเป็นสปริงปิด-เปิด ส่วนด้านศีรษะจะเป็นฝาปิด-เปิดแบบหมุนไป มา วัสดุที่ติดตั้งจะต้องปลอดภัยกับทารกแรกเกิด ความมั่นคงในการติดตั้ง

4.3 ระบบไฟฟ้าของตู้เด็กใช้ติดตั้งไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ และไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จาก แบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุ ผลิตรและติดตั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า

4.4 ตู้มีระบบควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในตู้ (Air Control) สามารถตั้งอุณหภูมิภายในตู้ได้ตั้งแต่ 22-38 °C หรือ

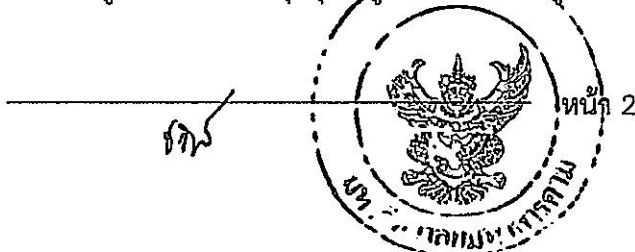

หน้า 2

Handwritten signatures and initials.

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีชิ้นงานก่อสร้าง)

เป็นช่วงที่มากกว่า มีปุ่มตรวจเช็คการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก ซึ่งจะอ่านค่าที่ $36.0 \pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ หรือมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$

4.5 ตู้อบเด็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลักซ์ (lux) และมีช่องสอดสายหรืออุปกรณ์ให้สารน้ำได้ (Tubing port) จำนวน 6 ช่อง หรือมากกว่า

4.6 สามารถให้ออกซิเจนเข้าภายในตู้ได้ โดยต่อเข้าที่ช่อง Oxygen Inlet การเชื่อมต่อต้องสะดวกในการเชื่อมต่อและปลอดภัยตามมาตรฐานการติดตั้งก๊าซทางการแพทย์

4.7 มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ในกรณีที่ตู้อบเด็กเกิดสภาวะไม่ปกติ อย่างน้อยดังนี้

4.7.1 กรณีอุณหภูมิอากาศภายในกระโจมสูงเกินกว่า $39 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (High Temp)

4.7.2 กรณีอุณหภูมิของ Heater สูงผิดปกติเกินกว่า $77 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (Heater Temp)

4.7.3 กรณีกระแสไฟฟ้าสลับที่ใช้เกิดขัดข้องหรือไม่ได้กวดสวิตช์เมื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (Power Fail)

4.7.4 กรณีพัดลมภายในชำรุดเสียหาย หรือหยุดหมุน (Air Flow)

4.7.5 กรณีตัววัดอุณหภูมิภายในเครื่องผิดปกติ (Sensor)

4.7.6 กรณีไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟมีค่าต่ำกว่าปกติ (Low DC)

4.8 ตู้อบเด็กจะต้องมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุได้ ขนาด 12 โวลต์ 24 แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) พร้อมสำหรับการใช้งานระหว่างเคลื่อนย้ายเด็ก

4.9 ตู้อบเด็กทารกจะต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN 60601-1 และ EN 60601-1-2 มีผลการทดสอบ IEC 60601 รับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยเฉพาะผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตู้อบเด็กในสภาวะแวดล้อมที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนต่อระบบการทำงานของอุปกรณ์

4.10 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีช่างเครื่องมือแพทย์ประจำบริษัท ซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทและต้องมีเอกสารรับรองการเป็นพนักงานประจำของบริษัทระบุตัวตนช่างเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 1 คน ในวันยื่นเสนอราคา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานประจำบริษัท เป็นต้น

4.11 ตู้อบเด็กแบบลำเลียงทารกแรกคลอด จะต้องมียุทธภัณฑ์ประกอบการใช้งาน อย่างน้อยดังนี้

4.11.1 ถาดและเบาะรองรับตัวเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

4.11.2 ชุดวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก (Skin Temperature Probe) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เส้น

4.11.3 ท่อออกซิเจน ขนาดที่สอดคล้องกับการใช้งานของตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ

4.11.4 ชุดวัดและควบคุมการไหลของออกซิเจน (O2 Flowmeter/Regulator) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

4.11.5 แผ่นกรองอากาศ (Micro Filter) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แผ่น

4.11.6 แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จประจุไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

4.12 ต้องมีคู่มือการใช้งานเครื่องอย่างง่าย หรือผังการใช้งาน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือวัสดุอื่นที่สามารถให้ผู้ใช้งานเรียนรู้เข้าใจได้ง่าย และปฏิบัติตามได้อย่างสะดวก จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

4.13 ผู้ขายจะต้องมอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บรรจุในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ให้งานวิศวกรรมชีวการแพทย์เก็บไว้ อย่างน้อยจำนวน 1 ชุด

4.14 ผู้ขายจะต้องส่งช่างเครื่องมือแพทย์ประจำบริษัทของตนเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาตู้อบเด็กแบบลำเลียงทารกแรกคลอด ทุก 6 เดือน ในระยะเวลารับประกันสินค้า โดยทุกครั้งที่เข้ามาจะต้องติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการและจะต้องมีหนังสือแจ้งเข้ามาก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการ อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ใช้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย



Handwritten signatures and initials.

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

5.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องเขียนลำดับเลขหน้า และ เลขข้อ พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความ ลงในเอกสารแสดงคุณลักษณะและรายละเอียดสินค้า (แค็ตตาล็อก) ของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ตรงตามเลขข้อในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดสินค้าที่กำหนดไว้ในร่างขอบเขตงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะต้องจัดทำลงในแบบตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่แนบให้ครั้งนี้

5.3 เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ส่งมอบจะต้องทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพพื้นที่ โครงสร้างต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งประกอบกับอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม

5.4 เพื่อความสะดวกในการติดต่อบริการหลังการขาย กรณีที่เป็นสินค้าคงทนถาวร ผู้ส่งมอบต้องติดต่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์สินค้าด้วยวัสดุชนิดติดแน่นไม่ลอกง่าย

ฯลฯ

6. กำหนดเวลาส่งมอบ

ต้องส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบจนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (เลือกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง)

8.1 () ใช้หลักเกณฑ์ ราคา โดยจะพิจารณาจากราคารวม

8.2 () ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 8.2.1 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน | น้ำหนัก..... |
| 8.2.2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ | น้ำหนัก..... |
| 8.2.3 บริการหลังการขาย | น้ำหนัก..... |
| 8.2.4 พักผู้รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน | น้ำหนัก..... |
| 8.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ | น้ำหนัก..... |
| 8.2.6 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น | น้ำหนัก..... |

9. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1 วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)


9.2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

10. เงื่อนไขการส่งมอบ

() ส่งมอบครบถ้วนทั้งหมดครั้งเดียว ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

() ส่งมอบเป็นงวด ตามที่กำหนดในสัญญา

() ส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

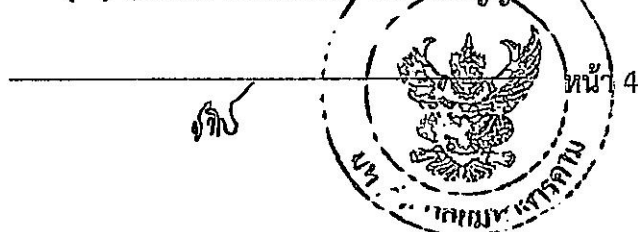

(Handwritten signatures and marks)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (งานซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีในงานก่อสร้าง)

11. สถานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

12. การจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาเมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา

13. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างหรือผู้เช่า เป็นรายวันในอัตราร้อยละ...0.2...บาท ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างหรือผู้เช่า ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

14. กำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ต้องรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมอะไหล่และการบริการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้อง

15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : โรงพยาบาลสุทธาเวช

โทรศัพท์ : 0 4372 2072 ต่อ 7897


ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


งานพัสดุ โทรศัพท์ : 0 4302 1021

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ส่งไปยังหน่วยงานของรัฐทางที่อยู่อีเมล medicine.egp@msu.ac.th ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายรัฐ สอนสุภาพ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปกาศิต มาหลิน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวชนิกานต์ วงษ์บัณฑิตย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางชุตีมา สืบสุนทร)

